


1号館3階タンパク実験室(3F10) 利用開始エリア

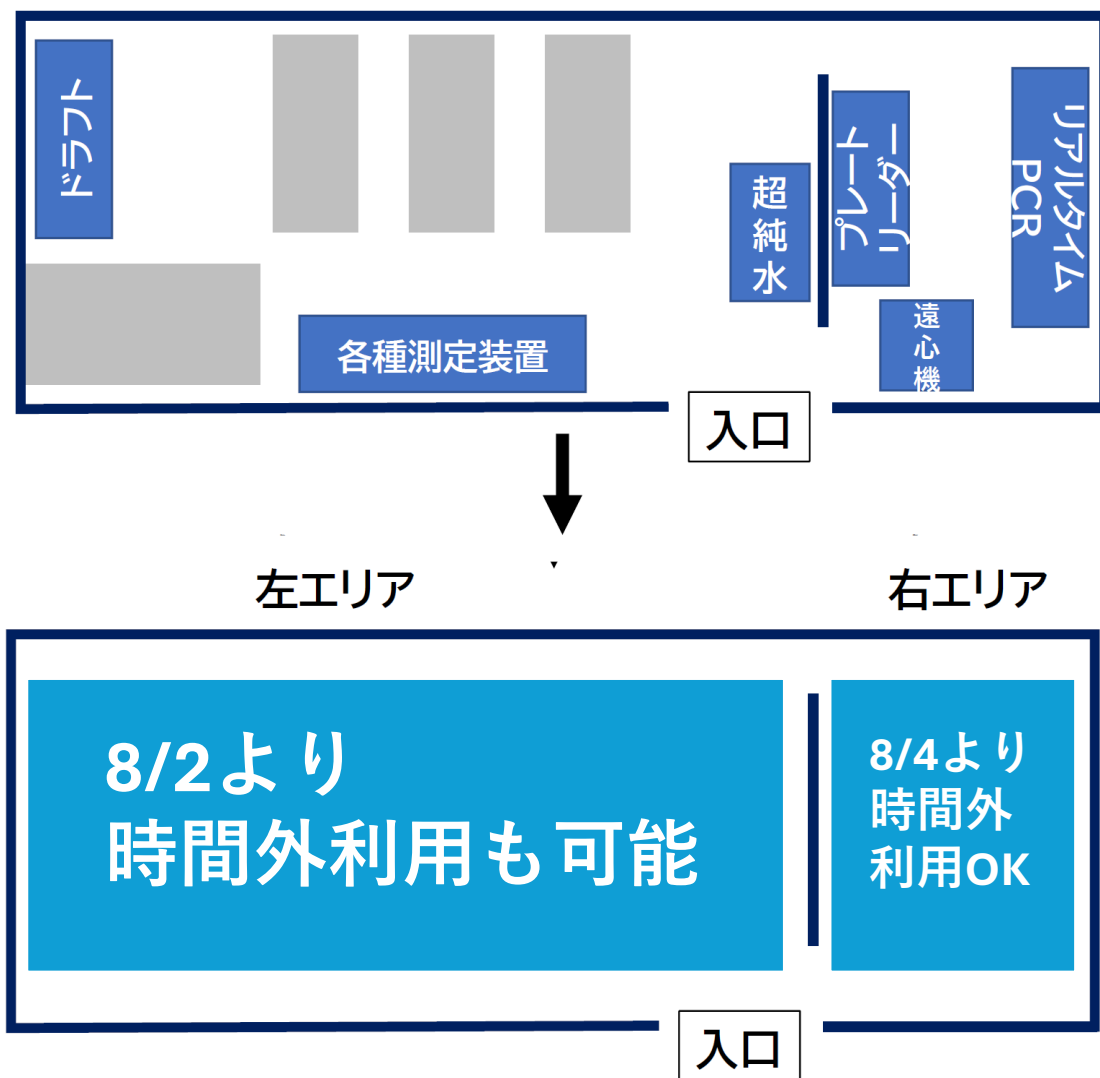

- ・ 8月4日より右エリアも一部の機器を除いて利用を再開。
- ・ リアルタイムPCR (Cobas z 480) とオートクレーブは引き続き利用を停止。
- ・ 機器の使用中に異変が生じた場合には、速やかにお知らせください。

問い合わせ 蛋白・分析化学チーム佐々木 (内線2553)
メール: ersc@tokai.ac.jp